

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2024-08-29-004569-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі:

Для розширення лікувальних процедур та підвищення якості реабілітації в МРЦ МВС України «Кремінці»

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-29-004569-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК CPV 021: - 33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, код НК 024:2023: 47790 — Система електромеханічна для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії для ортопедії

Очікувана вартість предмета закупівлі: 690 000.00грн. з ПДВ (шістсот дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформований з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі отриманих комерційних пропозицій.

Медико-технічні вимоги:

Апарат ударно – хвильової терапії - 1 шт:

Характеристики та параметри
Прилад застосовує неінвазивну терапію ударної хвилі
Наявність сенсорного кольорового дисплея діагоналлю не менше 5,7 дюймів
Можливість управління всіма параметрами безпосередньо з сенсорного дисплея
Відображення усіх параметрів терапії на дисплеї
Наявність енциклопедії яка містить інформацію про діагнози, можливі терапії та приклади використання пристрою
Розміри не більше 320 x 190 x 280 мм
Вага приладу 7 кг
Можливість збереження терапії
Після включення прилад проводить самодіагностику внутрішніх ланцюгів та своїх функцій
Можливість користувачеві встановити або змінити пароль пристрою
Наявність утримувача для аплікатора
Наявність аплікатору
Наявність 15 мм багатоцільового передавача
Наявність 9 мм мультифокусованого передавача
Наявність 15 мм фокусованого передавача
Можливість самостійної заміни передавача та змінного набору аплікатора
Інтенсивність імпульсів до 4 Бар
Частота імпульсу до 15 Гц
Вага аплікатору не більше 1,1 кг
Розміри аплікатору не більше ніж 40x280x140 мм
Наявність візок, який вироблений тим самим виробником що і прилад, і містить у собі Монтажну пластину, Шухляди, .Висувні коліщатка (опція)

Можливість під'єднати Кронштейн аплікатора до візку (опція)

Наявність Транспортний футляр (опція)

Наявність у компанії-представника авторизованого виробником сервісного центру

Наявність сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів

Завідувач відділення - лікар



Володимир ТЕПЛИЙ

Заступник начальника центру
з медичних питань - лікар




Василь ШЕРЕМЕТА

Уповноважена особа



Мирослава БОЙКО

Начальник МРЦ МВС України
«Кремінці»

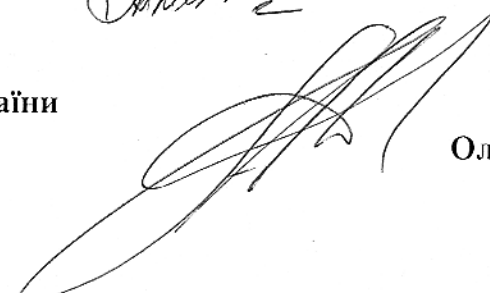

Олександр ДОМБРОВАН